機械器具(12)理学診療用器具

管理医療機器　特定保守管理医療機器　エアパッド特定加温装置システム　37328020

「ペーシェントウォーミングシステム PWU-5050 ベアーハガー」の構成品

輸液加温セット(FWS-2410)

再使用禁止

禁忌・禁止

- 本品の使用は一回限りとし、再使用・再滅菌しないでください。
- 本品の使用時は加圧輸液を行わないでください。[輸液ラインの破損やリークにより空気が混入すると、血液・輸液が汚染される可能性があります。また、空気の注入による空気塞栓を引き起こすことがあります。]

形状・構造および原理等

輸液加温セットは、螺旋状に巻いた輸液チューブと、輸液温度をモニタする温度計、クランプから構成されています。

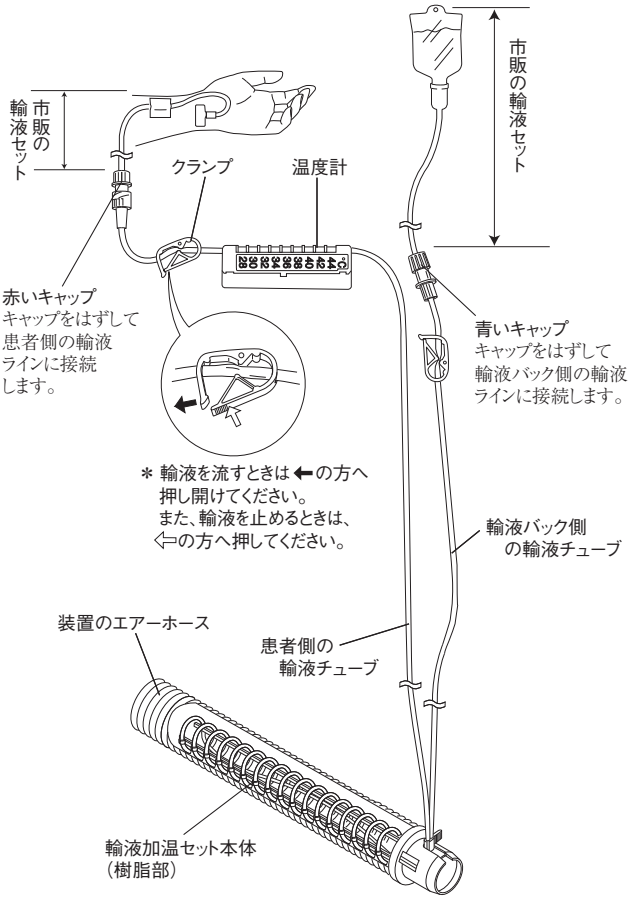

適用機種

本品は、アライザントヘルスケア社製の以下の装置と共に使用します。

名　称	承認番号
ペーシェントウォーミングシステム PWU-5050　ベアーハガー	20800BZY00168000
ベアーハガー　ペーシェントウォーミングシステム　モデル750	21600BZY00277000

使用目的、効能または効果

使用目的

組み合わせて使用する装置の添付文書を参照してください。

品目仕様等

組み合わせて使用する装置の添付文書を参照してください。

操作方法または使用方法等

組み合わせて使用する装置の添付文書(含む取扱説明書)をあわせて参照してください。

準　備



1. 輸液加温セットの青いキャップ側の輸液チューブ(温度計が付いていない方)を、輸液・輸血バックに接続し、輸液ラインを輸液で完全に満たします。
   [注]輸液ラインに気泡が混入しないように十分に注意してください。



2. PWU-5050使用時は、エアーホース先端のロックレバーをOPEN側にスライドさせて切り口を開きます。
3. 赤いキャップの付いた輸液チューブ(温度計が付いている方)を本体(樹脂部)先端からはずします。
   ※チューブが長いので本体に巻き付けてあります。



4. 本体(樹脂部)を装置のエアーホース内に挿入します。
5. 輸液加温セットのレバーを、エアーホース先端の切り口に奥までしっかりと挟み込みます。
   ※PWU-5050使用時は、エアーホースのロックレバーをCLOSE側にスライドさせ切り口を閉じます。

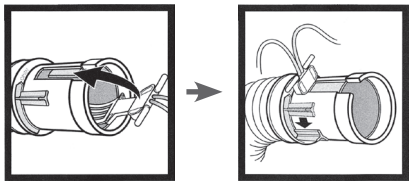



6. ウォーミングカバーのホース挿入口にエアーホースを接続します。



7. 赤いキャップ側の輸液チューブを患者側の輸液ラインに接続します。
   [注]接続時は輸液ラインに気泡が混入しないように十分に注意してください。

0654-J00136

使用開始

1. 装置の電源をONにし、適切な温度に設定します。
   ※ウォーミングカバー上部の溝に患者側の輸液チューブを挟み込むと、輸液・輸血の放熱を防ぐことができます。

2. 輸液を開始します。
   輸液温度は、輸液チューブに取り付けられた温度計で確認します。
   ※輸液温度は緑色で表示します。℃と°Fで確認できます。



終　了

1. 輸液を停止し、装置の電源をOFFにします。
2. 輸液加温セットを装置および輸液回路から取り外し、廃棄します。

使用上の注意

重要な基本的注意

- 本品はベアーハガー PWU-5050またはベアーハガー モデル750と共に使用してください。[指定外の装置に接続して使用すると、輸液・輸血温度が適正範囲を超えることがあります。]
- 包装が既に開封または破損、汚損している場合や、チューブキャップがはずれているなど、異常が認められる場合は使用しないでください。また開封後は速やかに使用してください。
- 使用前にプライミングを行い、輸液ライン内の空気を完全に除去してください。また、使用中に輸液ラインに空気が混入した場合は、除去するか使用を中止してください。[輸液ライン内に空気が残っていると、空気塞栓を引き起こすことがあります。]
- 装置の温度警報ランプが点灯し、警報音が鳴ったときは、装置の電源をOFFにし、直ちに本品の使用を中止してください。

貯蔵・保管方法および使用期間等

使用環境条件

温度範囲	10～40℃
湿度範囲	30～75%(結露なきこと)

保存環境条件

温度範囲	－40～70℃
湿度範囲	10～100%(結露なきこと)

使用期限

滅菌年月より3年以内(製造業者データの自己認証による)
※使用期限は包装箱と包装袋に記載されています。

保守・点検に係る事項

廃　棄

使用後は、医療廃棄物として、他のゴミと混ぜずに各自治体または施設の基準に従って廃棄してください。

包　装

10セット／箱(1セット1梱包)

製造販売 日本光電 日本光電工業株式会社
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
(03)5996-8000(代表) Fax(03)5996-8091

外国製造業者 アライザント ヘルスケア インク
(Arizant Healthcare Inc.)
(アメリカ合衆国)